


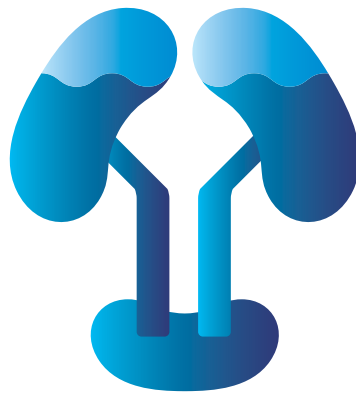

西日本泌尿器科学会

THE WEST JAPAN UROLOGICAL ASSOCIATION


WJUA

THE WEST JAPAN UROLOGICAL ASSOCIATION

ロゴマーク コンセプト

尿を作り出し、体外に排出するために働く泌尿器を表現するため、液体が分離されていく様子を表しています。

老廃物が濾過、選別され、体外へ排出されることにより健康を保つことができるということをイメージできるように、爽やかなブルーのグラデーションで親しみやすいマークになっています。

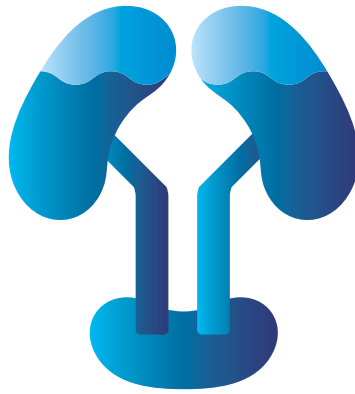

西日本泌尿器科学会

THE WEST JAPAN UROLOGICAL ASSOCIATION

カラーリング（色指定）〔フルカラー〕

ロゴマークを使用する際は、以下の色指定を守ってください。



①




〔プロセス〕 C:100 M:60 Y:0 K: 0
〔RGB〕 R:0 G:91 B:172
〔DIC〕 DIC641

②



〔プロセス〕 C:100 M:95 Y:30 K: 0
〔RGB〕 R:25 G:47 B:114
〔DIC〕 DIC184

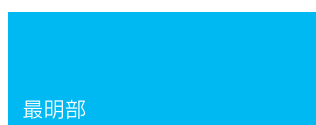


〔プロセス〕 C:80 M:0 Y:0 K: 0
〔RGB〕 R:0 G:175 B:236
〔DIC〕 DIC2176

③



〔プロセス〕 C:100 M:27 Y:0 K: 0
〔RGB〕 R:0 G:132 B:207
〔DIC〕 DIC2590

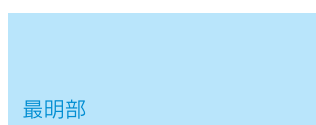


〔プロセス〕 C:25 M:0 Y:0 K: 0
〔RGB〕 R:199 G:232 B:250
〔DIC〕 DIC20


カラーリング（色指定）〔モノクロの場合〕

ロゴマークを使用する際は、以下の色指定を守ってください。

●グレースケールで背景が K0 の場合

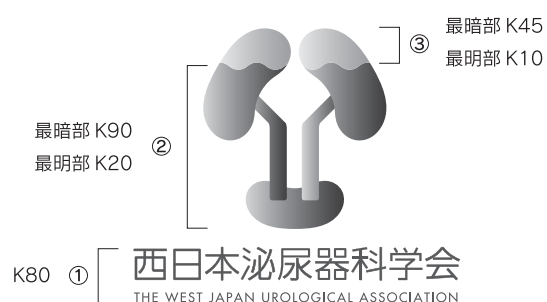

●グレースケールで背景が K100 の場合

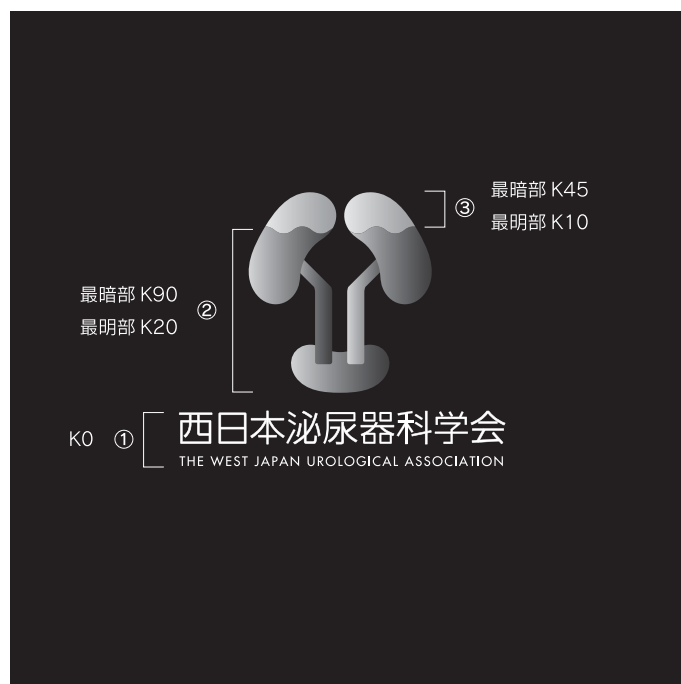

カラーリング（色指定）〔背景色〕

●背景の基本色は白（K0）とします。



●背景がマークと同色、または適切な表示ができない場合、以下の余白を確保してください。



●背景とロゴマークが、十分なコントラストが得られる場合は、使用可能とします。



●黒



●薄い色



●明るい色

●ロゴマークが認識しづらい背景色（同系色、同明度、同彩度など）は禁止します。
（この場合、上記の余白を確保して表示してください。）



ロゴマークのサブパターンを用意しました。

●日本語横組み



●英字横組み



●日本語ロゴタイプ



●英字ロゴタイプ



●ロゴマークのみ





●英字基本パターン



ロゴマークを使用する際には、天地左右に以下の余白をキープしてください。

(ロゴマークのみ、ロゴタイプのみの場合も下記に準じて余白をキープしてください。)

●基本ロゴマーク

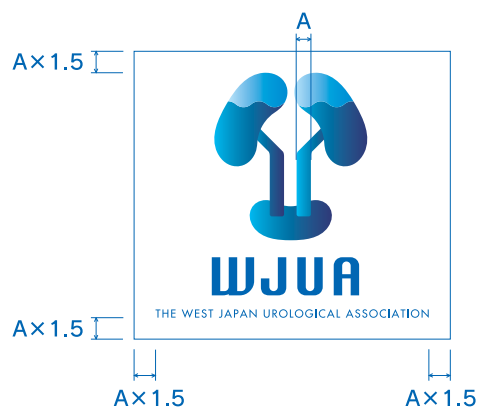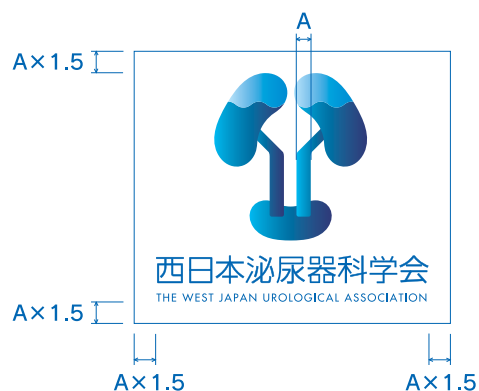

●横組みパターン



使用サイズ

印刷物でロゴを使用する場合、下記のサイズを最小使用サイズとします。これ以下のサイズに縮小すると、細部がつぶれ、再現性や美しさを欠く恐れがあります。


●日本語基本



●英字基本



●日本語横組み



●英字横組み



●日本語ロゴタイプ



●英字ロゴタイプ



●ロゴマークのみ



使用禁止例

ロゴマークを使用する際は、統一したイメージを損なわないよう、
以下の使用禁止例を参考にご注意ください。

●指定色を変えない



●変形させない



●傾けない



●複雑な背景上に使用しない



●十分なコントラストが
得られない表示をしない



●加工しない

